DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM



RETRACTOR TORACO-LUMBAR POSTERIOR

OVERFIX+ SPINE

CATÁLOGO

SET DE INSTRUMENTAL RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
12040001	1	Dilatador, 10	
12040002	1	Dilatador, 14	
12040003	1	Dilatador, 18	
12040004	1	Dilatador, 21.8	
12040009	1	Marco del separador, craneal/caudal	
12040010	1	Marco del separador, medial/lateral	
12040011	1	Hoja craneal/caudal, derecha, 40mm	
12040012	1	Hoja craneal/caudal, derecha, 50mm	
12040013	1	Hoja craneal/caudal, derecha, 60mm	
12040014	1	Hoja craneal/caudal, derecha, 70mm	
12040015	1	Hoja craneal/caudal, derecha, 80mm	
12040016	1	Hoja craneal/caudal, izquierda, 40mm	
12040017	1	Hoja craneal/caudal, izquierda, 50mm	
12040018	1	Hoja craneal/caudal, izquierda, 60mm	
12040019	1	Hoja craneal/caudal, izquierda, 70mm	
12040020	1	Hoja craneal/caudal, izquierda, 80mm	
12040021	2	Llave para hojas	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
12040022	2	Hoja medial/lateral, estrecha 50mm	
12040023	2	Hoja medial/lateral, estrecha 60mm	
12040024	2	Hoja medial/lateral, estrecha 70mm	
12040025	2	Hoja medial/lateral, estrecha 80mm	
12040026	2	Hoja medial/lateral, estrecha 90mm	
12040027	2	Hoja medial/lateral, ancha 50mm	
12040028	2	Hoja medial/lateral, ancha 60mm	
12040029	2	Hoja medial/lateral, ancha 70mm	
12040030	2	Hoja medial/lateral, ancha 80mm	
12040031	2	Hoja medial/lateral, ancha 90mm	
12040032	1	Brazo flexible	
12040033	1	Conector del brazo flexible	
12040034	1	Abrazadera de mesa	
12040035	Opcional	Cable de luz	
12040036	Opcional	Fuente de luz	
12040991	1	Caja de instrumental	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

CAJAS DE INSTRUMENTAL

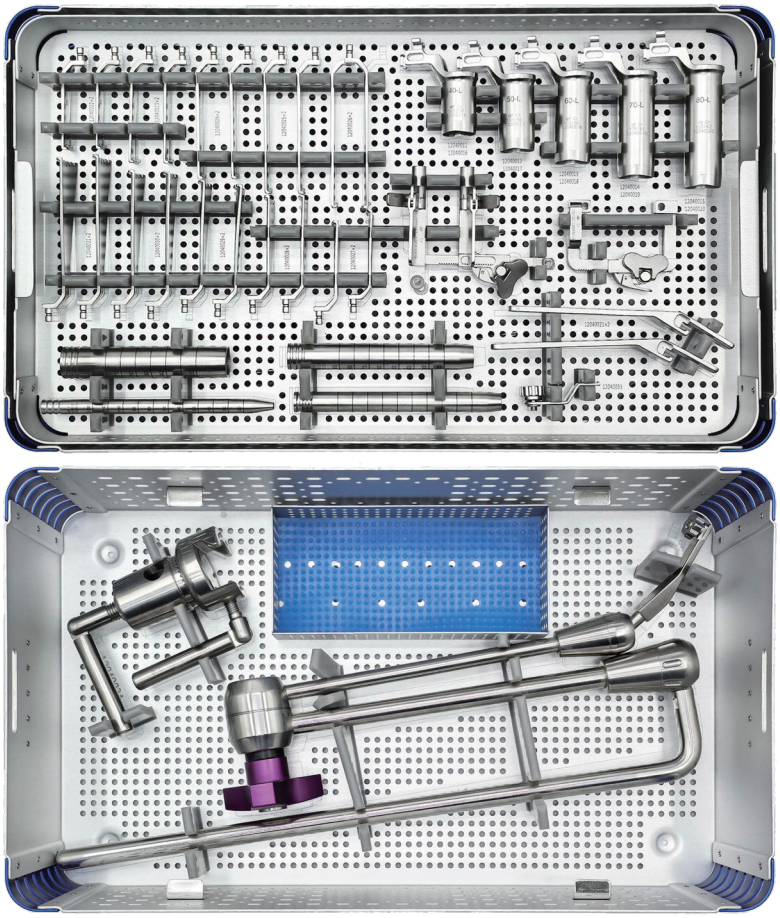

Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.
Tel: +54 11 7506 8730
bioadvancelatam.com

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM



RETRACTOR TORACO-LUMBAR POSTERIOR

OVERFIX+ SPINE

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SET DE INSTRUMENTAL RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR


SECUENCIA

USO PREVISTO, IMPLANTES E INSTRUMENTOS COMPATIBLES

El Set de Instrumentos de Separación Toracolumbar Posterior está diseñado para utilizarse con el dispositivo de fusión intersomática Coales-T y su correspondiente set de instrumentos. Su función es establecer un corredor quirúrgico para la preparación del espacio intervertebral e inserción del implante en procedimientos de fusión intersomática lumbar transforaminal mínimamente invasiva (MIS-TLIF).

01. POSICIÓN DEL PACIENTE


Se coloca al paciente en decúbito prono sobre una mesa adecuada para fluoroscopia.

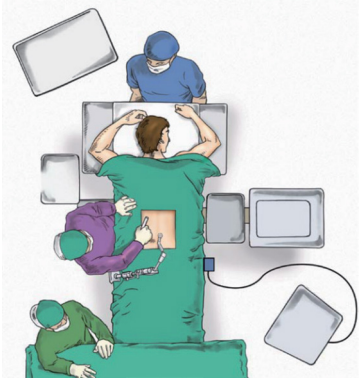

02. LOCALIZACIÓN E INSERCIÓN INICIAL DEL DILATADOR

Realice una incisión en el nivel espinal previsto.

Trayectoria TLIF

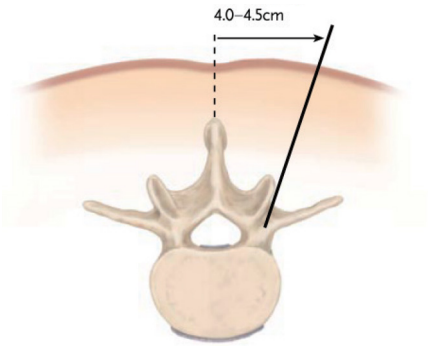

Inserte los dilatadores de forma secuencial.



SECUENCIA


03. ACOPLAR EL BRAZO FLEXIBLE

Asegure la Abrazadera de Mesa (12040034) a la mesa quirúrgica. Inserte la varilla de conexión del Brazo Flexible (12040032) en el orificio de la abrazadera de mesa. Gire el mango de la abrazadera en sentido horario para bloquear la varilla de conexión del brazo flexible en su lugar.




04. ENSAMBLAR EL SEPARADOR

Gire la tuerca del Conector del Brazo Flexible (12040033) en sentido horario para acoplarlo al Marco del Separador, Craneal/Caudal (12040009).

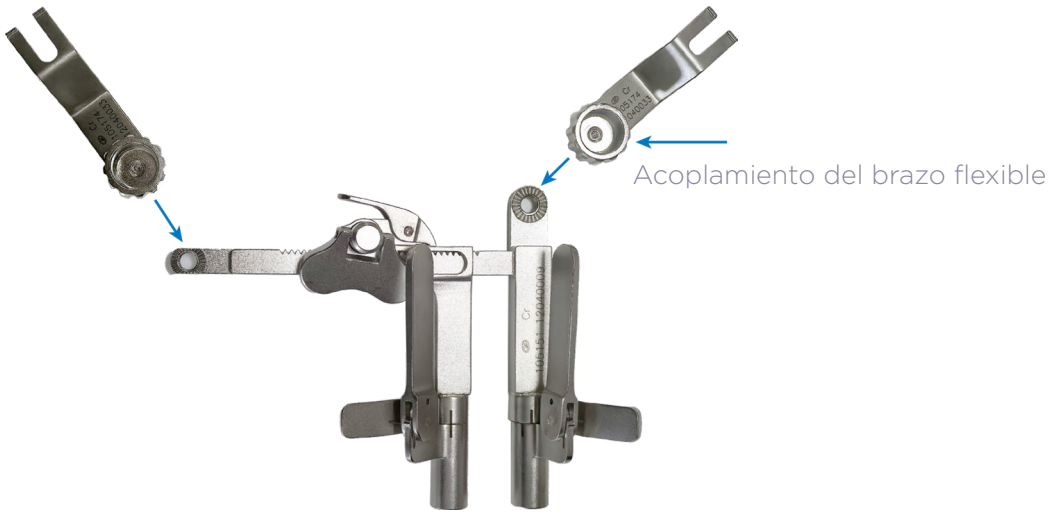


SECUENCIA

Presione el botón en el Marco del Separador (12040009) para cerrar sus brazos. Presione el botón de ajuste de ángulo en el marco para ajustar el ángulo de la punta distal hasta que las líneas queden alineadas.

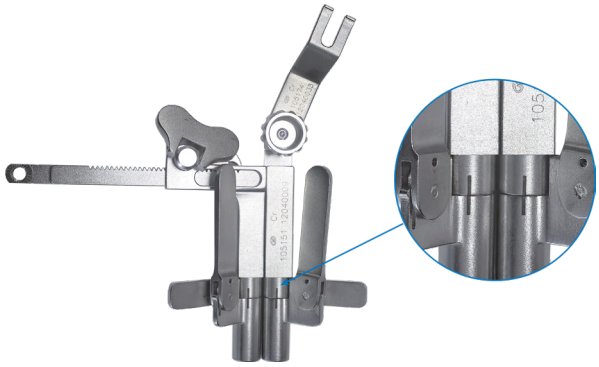


Seleccione la longitud adecuada de la Hoja Craneal/Caudal (12040011-12040020) y acóplelas al Marco del Separador, Craneal/Caudal (12040009).

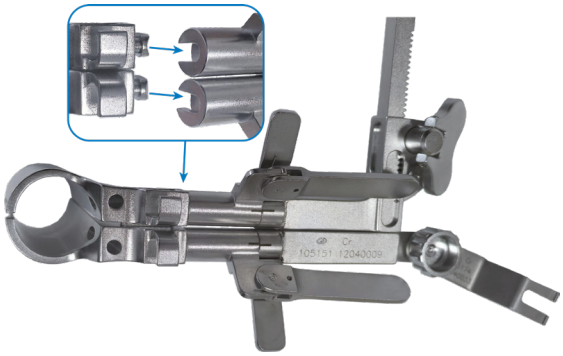

05. INSTALACIÓN DEL SEPARADOR CEFALOCAUDAL

Inserte el Marco del Separador, Craneal/Caudal (12040009) ensamblado a lo largo del Dilatador (12040004); luego, retire el dilatador (12040004).

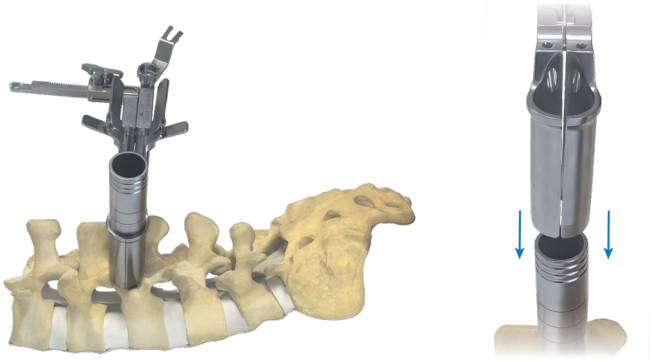


RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR


TÉCNICA QUIRÚRGICA | RETRACTOR TORACOLUMBAR POSTERIOR

SECUENCIA


Conecte el Conector del Brazo Flexible (12040033) del Marco del Separador (12040009) al Brazo Flexible (12040032). Ajuste la posición del brazo flexible y gire su perilla en sentido horario para bloquearlo en su lugar.

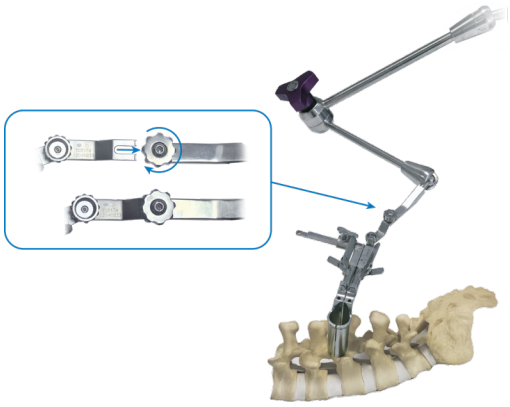

Inserte el Cable de Luz (12040035) en el orificio de la Hoja Craneal/Caudal (12040011-12040020).

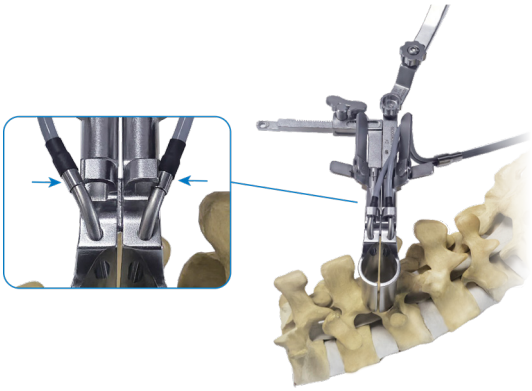

Gire la perilla del Marco del Separador, Craneal/Caudal (12040009) para realizar una separación paralela. Utilice la Llave para Hojas (12040021) para realizar la separación angular. Ajuste la palanca de sintonía fina en el marco del separador para ajustar con precisión el ángulo.

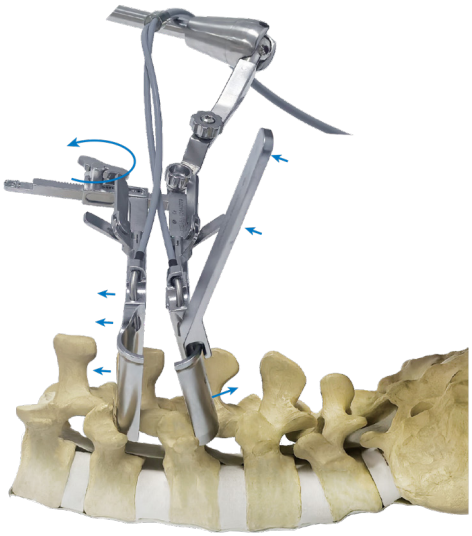

SECUENCIA

06. INSTALACIÓN DEL SEPARADOR LATERAL

Si se requiere una separación lateral, acople la Hoja Medial/Lateral (12040022-12040031) al Marco del Separador Medial/Lateral (12040010); luego, colóquelo en el campo quirúrgico. Ajuste la perilla del Marco del Separador Medial/Lateral (12040010) para realizar la separación lateral.





07. RETIRAR EL SEPARADOR

Realice la preparación intervertebral e inserte el dispositivo de fusión intersomática utilizando los métodos convencionales.
Asegure con tornillos pediculares y, posteriormente, retire el sistema separador.