OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

TÉCNICA QUIRÚRGICA

DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE MENISCOS | ALL-INSIDE MENISCAL REPAIR SYSTEM OVERFIX

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

CONTENIDO

T-LOCK MENISCAL REPAIR SYSTEM

Características ---------- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dispositivo de Reparación de Meniscos ---------- 04

CODIFICACIÓN

Dispositivo de Reparación de Meniscos | Instrumental ---------- 06



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

Contiene un despliegue activo de dos implantes de PEEK de perfil ultra bajo, los cuales son expulsados desde la punta de la aguja de administración, minimizando la penetración excesiva del menisco.

El implante está integrado en una aguja T1 de 1.0mm que ayuda a minimizar la lesión del menisco. La aguja curva de 10° está diseñada para que proporcione un fácil acceso al desgarre.



ERGONOMÍA

El ergonómico mango de cigarro y el activo control deslizante de 360° está diseñado para una sola mano. Entrega del implante en cualquier rotación.



AJUSTABLE

El botón de profundidad puede ser rápidamente ajustado a diferentes longitudes, según el grosor del menisco.



DESPLIEGUE ACTIVO DEL IMPLANTE A 360°

Despliegue activo de dos anclajes, facilitando la selección de la posición y el ángulo de implantación óptimos. El sonido de aviso asegura la liberación efectiva del implante.

SUTURA PRECARGADA

Precargado con sutura de fibra UHS #2-0 y nudo deslizante proporciona reparación artroscópica segura de todo el interior del menisco.




T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

TÉCNICA QUIRÚRGICA | DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE MENISCOS

SECUENCIA


01. INSERCIÓN DE AGUJA

Utilice la cánula ranurada para insertar la punta de la aguja T-Lock™ en la ranura deslizante y empújela hacia la zona dañada. Mida la distancia desde el punto de punción hasta el borde externo del menisco.

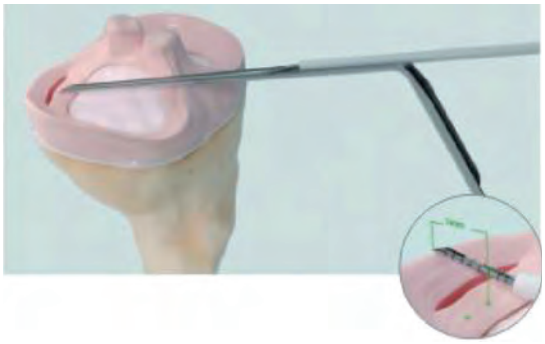

02. AJUSTE DE PROFUNDIDAD

De acuerdo con la medición, ajuste el tope de profundidad para controlar la profundidad de la punción.

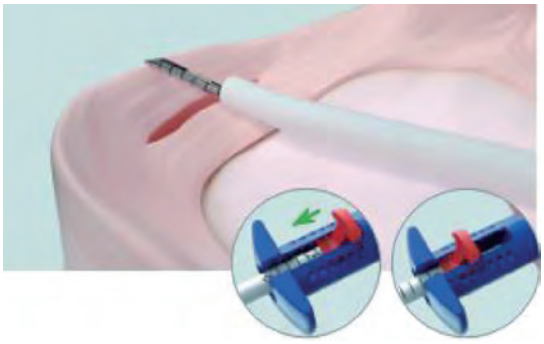

03. DESPLIEGUE

Realice la punción desde el primer punto de entrada de la aguja e inserte completamente la aguja de punción en el menisco. Empuje el anillo de despliegue del implante activo. Escuche el sonido de “clic” para completar el despliegue. Retire el anillo y extraiga la aguja de punción.



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

TÉCNICA QUIRÚRGICA | DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE MENISCOS

SECUENCIA


04. PUNCIÓN

Realice la punción desde el segundo punto de entrada de la aguja. Repita el paso anterior y retire la aguja de punción una vez completado.



05. CORTE DE SUTURA

Utilice el cortador de sutura #2-0 para empujar y ajustar el nudo deslizante preestablecido, y corte el hilo después de haberlo apretado.

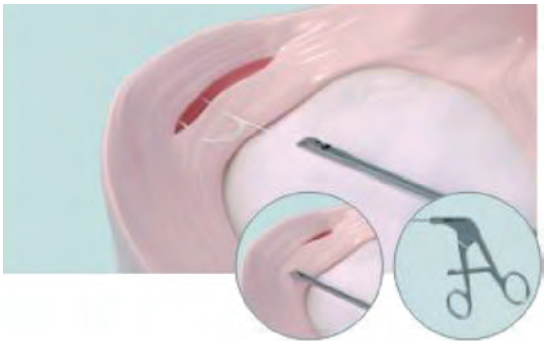

06. ALL-INSIDE

Complete la reparación del menisco mediante el procedimiento all-inside.



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CIGAR HANDLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
		All-Inside Meniscal Repair System Overfix	
91-8901-002-00	**Menisco**	Sistema de Reparación de Meniscos, Cigar Handle, Curvo	

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
91-9806-000-11	Raspa de Menisco, 90°
91-9806-000-12	Raspa de Menisco, 40°
91-9806-000-13	Tijeras para Menisco, Recto
91-9806-000-14	Tijeras para Menisco, Izquierda
91-9806-000-15	Tijeras para Menisco, Derecha
91-9806-000-17	Cánula Ranurada
91-9806-000-18	Sonda, 3mm
91-9806-000-19	Bajador y cortador de nudos

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO | jri Ortopedics | OVERFIX® TRAUMA | OVERFIX® | OVERFIX® SPORTS MEDICINE | OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA | CERTIFIED ISO 13485 | CE | FDA | TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | AGEMED | anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com